


pH&Buffer Mate100 制御レポート

制御条件

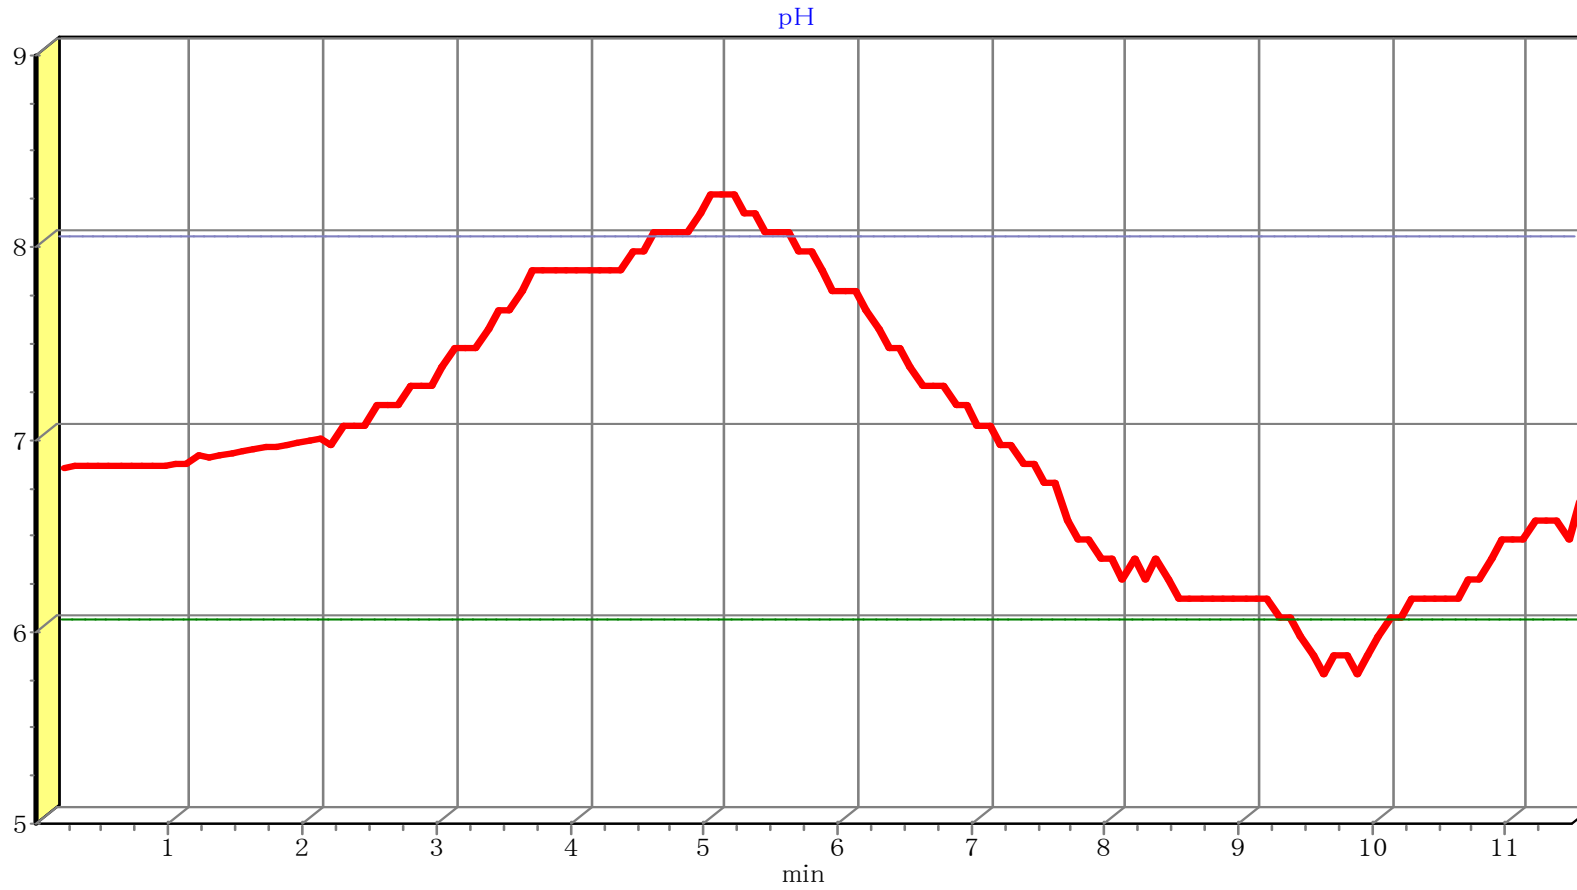

Acid Port = 2

Base Port = 3

Valve Time = 25

Wait Time = 100

TargetpH = 7.0

Interval = 2

